


低压型气密检测仪 Low-Pressure Air Leak Tester




FL-295C 系列 Series

- 调压阀稳压精度可达0.1kPa (UL可达0.01kPa)
- 泄漏单位Pa、ml/min可选
- 被测物容积可自动读取或手动输入
- 500组测试数据存储，最新99组数据查看
- 最多16组测试通道
- 9999个数据统计 (OK、NG、P. NG个数)
- 通讯接口支持软件升级

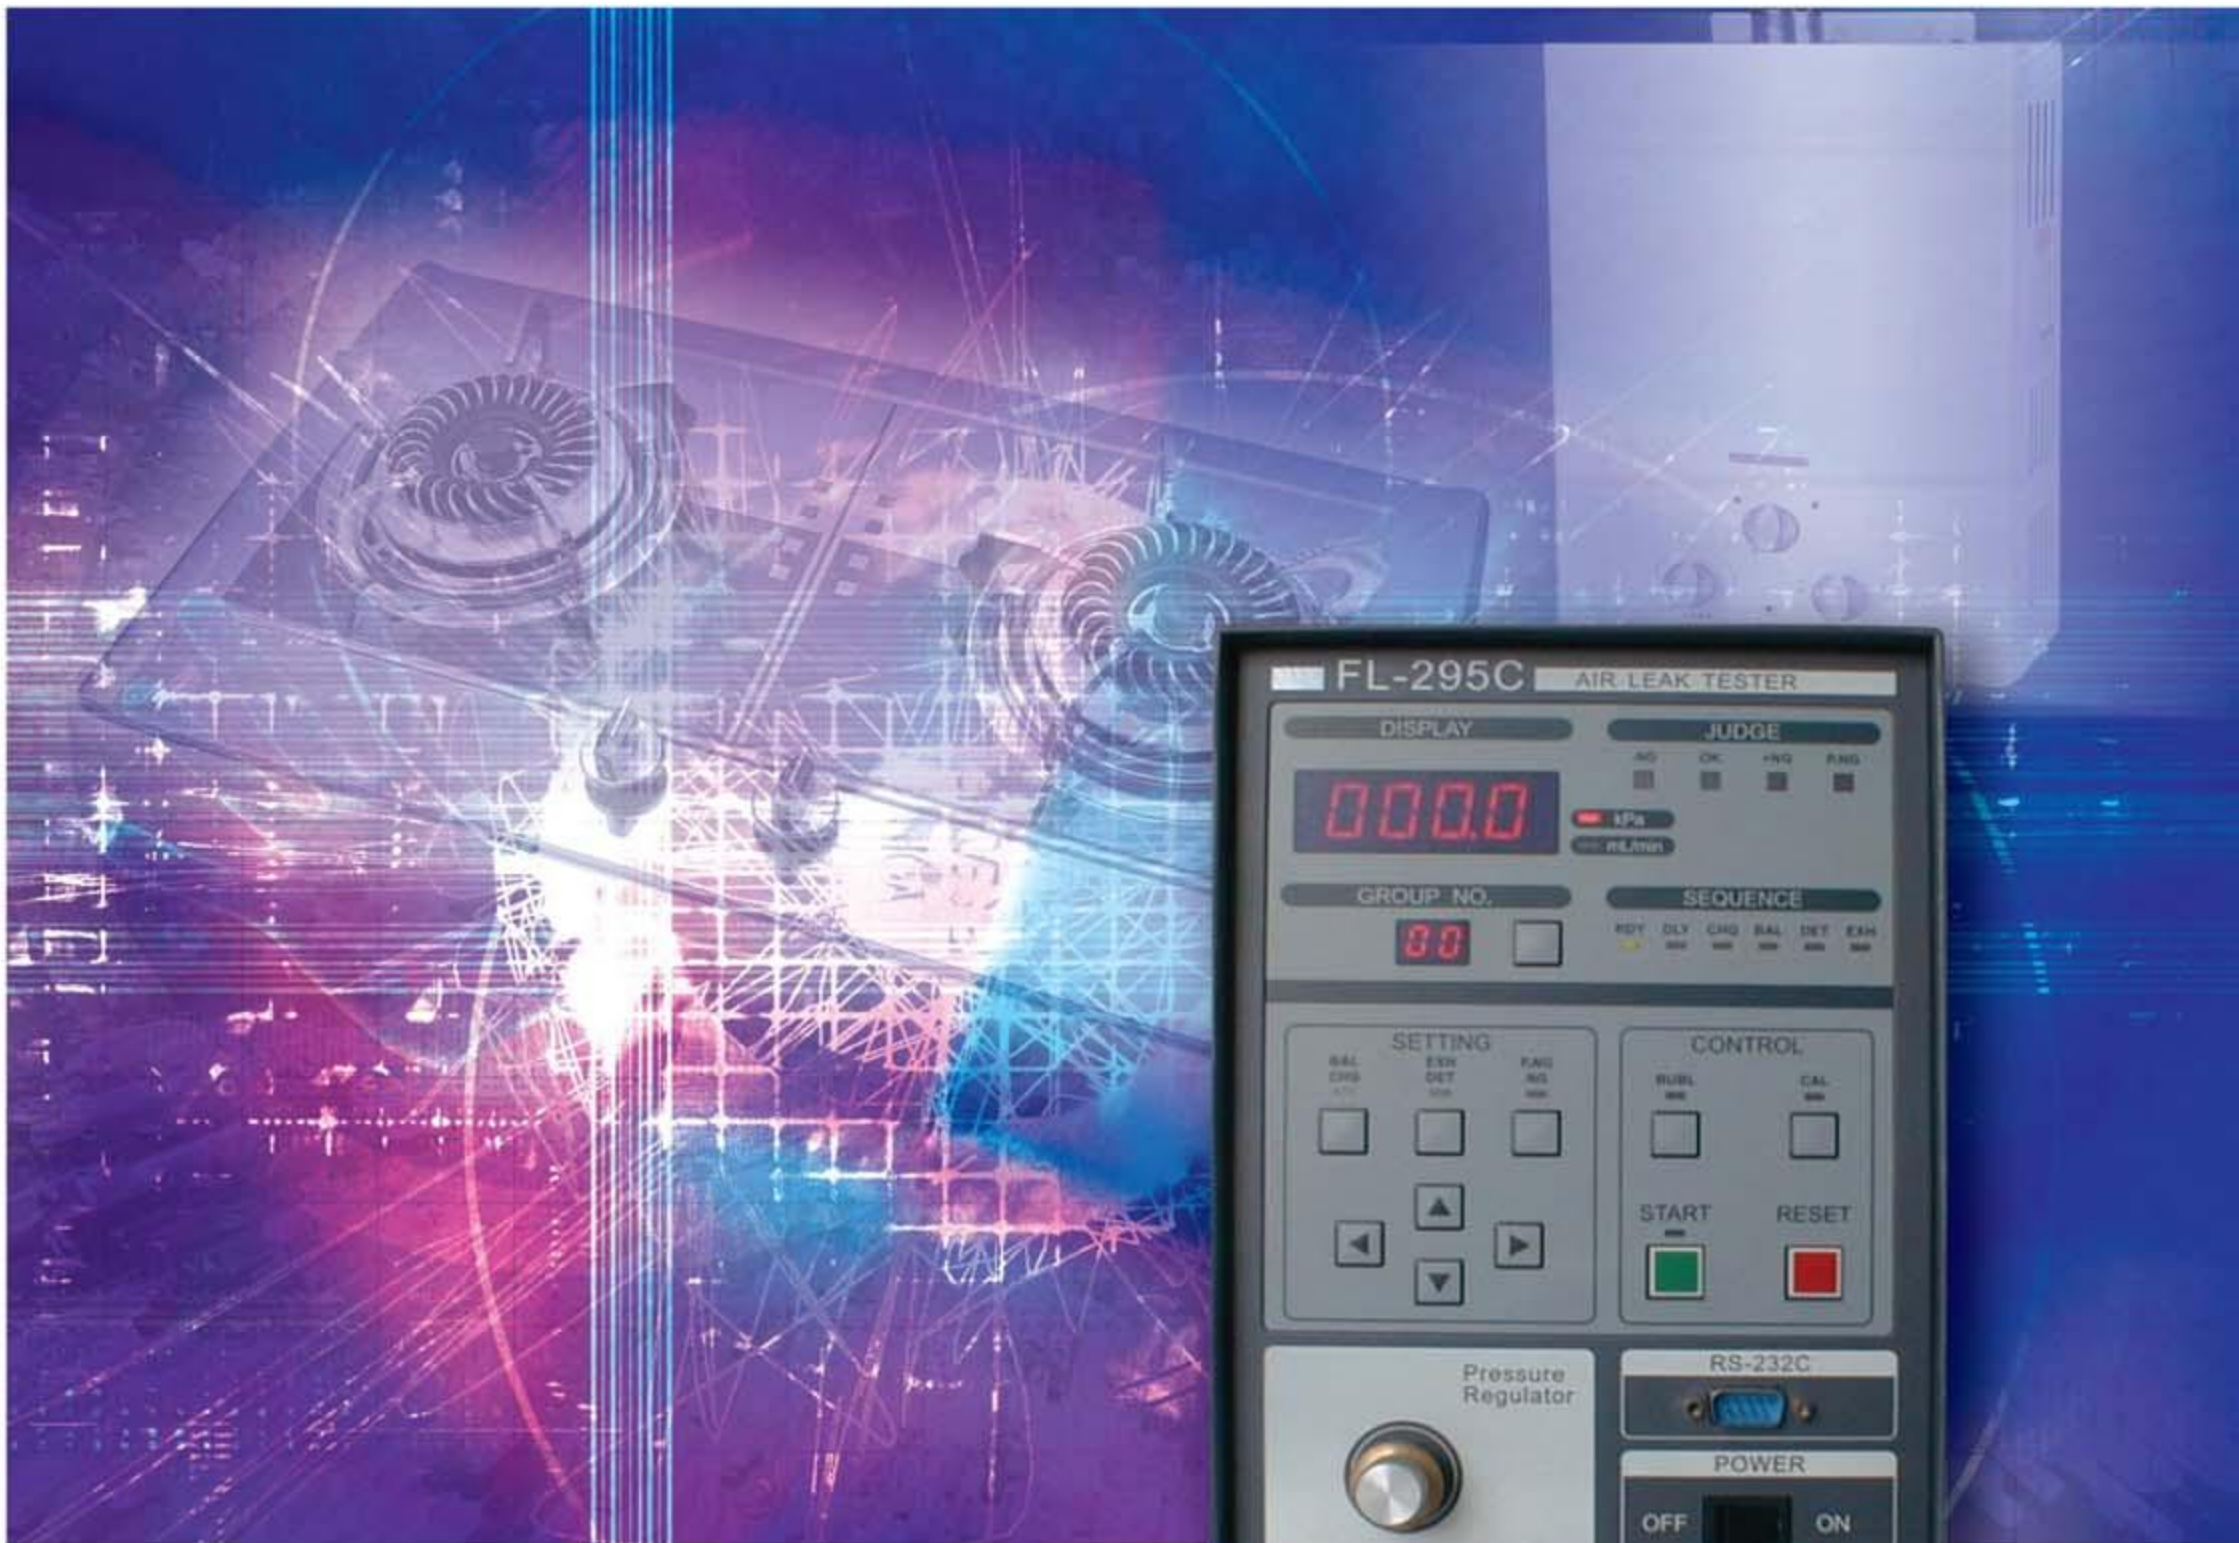

- Regulator Accuracy Can Reach 0.1kPa (UL Can Reach 0.01 kPa)
- Leakage Units: Pa, ml/min
- Work Volume Can be Loaded Automatically or Inputted Manually
- Can Memory 500 Groups Testing Data, View Latest 99 Groups Data
- Maximum 16 Groups Testing Channels
- 9999 Data Statistics (OK,NG,P.NG)
- Support Communication Port Software Upgrading

外形尺寸 Dimensions (mm)

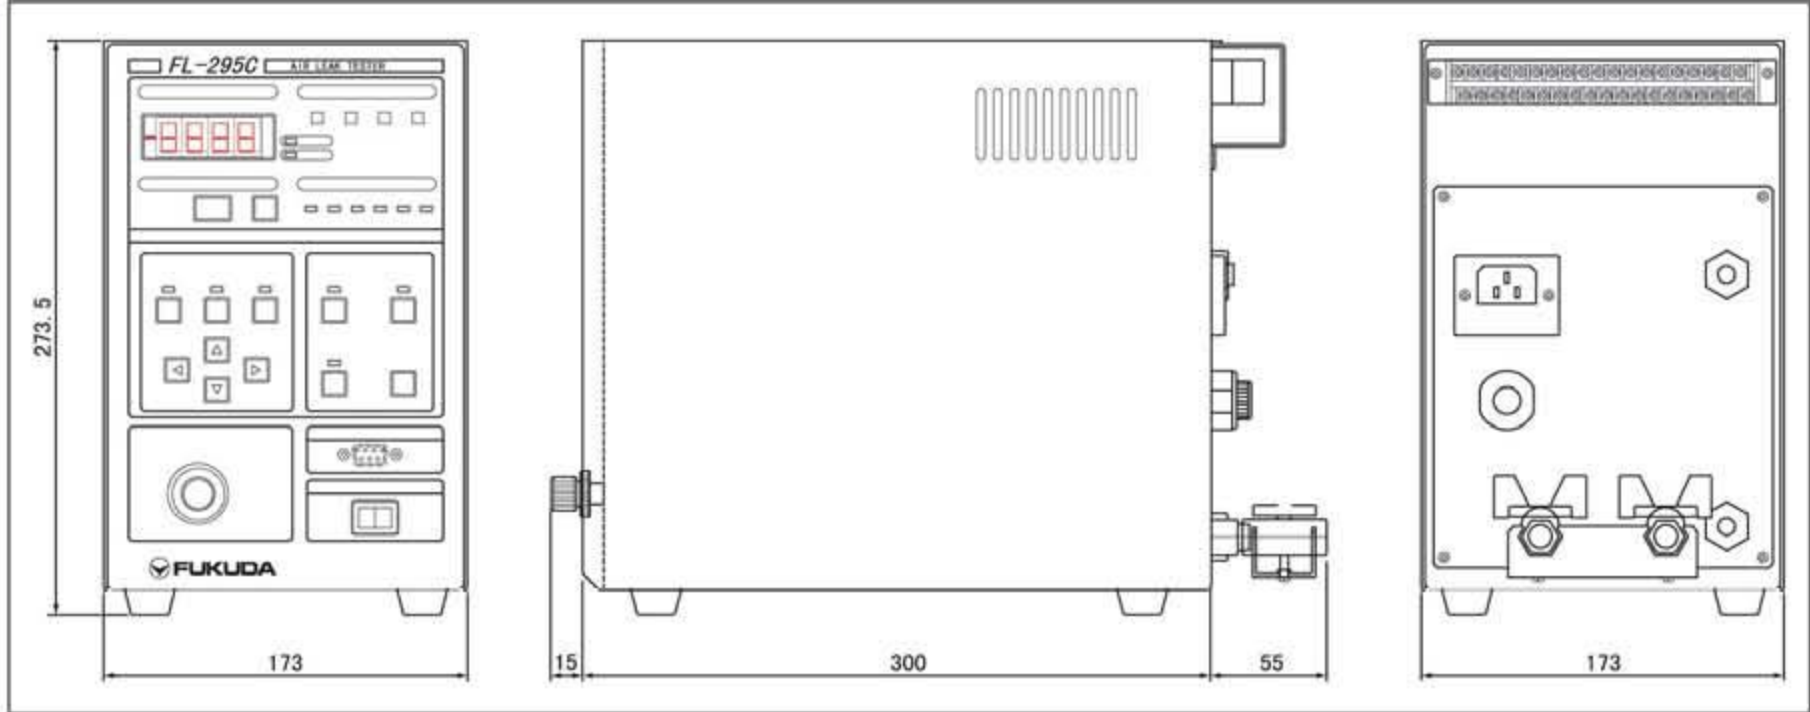

选型 FL-295C ①-②-③ Ordering Information

① 测试范围 Testing Range

记号 Model	测量范围 Measuring Range (ml/min)	被测容积范围 Work Volume (ml)	测试压范围 Test Pressure (kPa)
UL	0.010~2.000	5~200	0.50~10.00
S	0.010~2.000	5~200	3.0~50.0※
L	0.25~9.99	100~1000	3.0~50.0※

※ 测试压力超出范围需特制 ※ Customized product can be provided if test pressure is out of range.

② 选购品 Options

记号 Model	含义 Descriptions
P	打印机 Printer Output
R	RS-232C输出 RS-232C Output

③ UL用调压装置 Pressure Adjustment Equipment for Mode UL

记号 Model	含义 Descriptions
FR 11	调压阀(0.50~10.00kPa用) Regulator
PC-295	压力切换盒(0.50~20.00kPa用) Pressure Switching Box

技术指标 Specifications

参数 Parameters

测试方式 Test Method	差压比较方式 Differential Pressure Measurement Method	
压力传感器 Pressure Sensor	差压传感器 Differential Pressure Sensor F.S. ±1000Pa	
	直压传感器 Gauge Pressure Sensor	S、L F.S. 100kPa UL F.S. 20kPa
时间设置 Time Settings	CHG (充气 Charge)	0.2~999.9
	BAL (平衡 Balance)	0.2~999.9
	DET (检测 Detect)	0.2~99.9
	EXH (排气 Exhaust)	1~999.9
	单位 Unit	秒 Second
组别设定内容 Group Setting Function	CHG、BAL、DET、EXH、±NG、P.NG、校正值 Calibrating Value	
辅助功能 Auxiliary Function	BUBL (气泡测试 Bubble Test) CAL (校正 Calibration)	
显示 Display	S/UL 系列为4位数字显示, L系列为3位数字显示 S/UL Series: 4 Digits Display L Series: 3 Digits Display	
输入输出 I/O	外部输入输出端子 (38 针) External I/O Terminal (38 pin)	
	输出选择: Output Options	* 打印机 Printer * RS-232C (9 针) RS-232C (9 Pin)
系统组成 System Structure	检漏仪内部带有控制驱动器, 只要配备了夹具、气缸、电磁阀及开关后, 即可经济、方便地组成整个检测系统。 There is a control drive in the leak tester, as long as it is equipped jig, cylinder and solenoid valve, they can be consisted a whole testing system in convenient and economical ways.	

温度范围 Temperature Requirement	0~40℃
湿度范围 Humidity Requirement	35~85%RH (无结露现象 No Dew)
电源电压 Power Supply	AC85~265V (50/60Hz)
功率 Power Consumption	60W
重量 Weight	8kg
气源要求 Air Supply Specifications	洁净、干燥、压力稳定的空气 Clean, Dry, Stable Air
	建议条件 Optimal
一次压力 Inlet Pressure	100kPa

主要产品 ● 气密检漏仪 ● 数字压力表 ● 流量计 ● 自动压力、流量控制器 ● 密封性能检测专用设备

天津博益气动股份有限公司 TIANJIN BOYI PNEUMATICS CO., LTD.

公司·工厂: 天津经济技术开发区第九大街80号丰华工业园7号厂区(300457)

电话: (86)22-59810966 传真: (86)22-59810963

邮箱: sales@boyiqd.com

网址: www.boyiqd.com

北京营销中心: 北京市丰台区角门18号名流未来大厦801-805(100068)

电话: (86)10-87582461 传真: (86)10-87582462

广州办事处: 广州市天河区体育东路122号羊城国际商贸中心西塔2113-2114室(510620)

电话: (86)20-38870513 传真: (86)20-38870733

杭州办事处: 杭州市清泰街571-573号金泰商务大厦905室(310002)

电话: (86)571-87850044 传真: (86)571-87850351

重庆办事处: 重庆市江北区建新东路同创国际11号楼15-9(400024)

电话: (86)23-68582856 传真: (86)23-68585616

武汉办事处: 武汉市洪山区珞狮路205号南区5-3-401(430070)

电话: (86)27-87156659 传真: (86)27-87156657

上海办事处: 上海浦东陆家嘴金融贸易区向城路58号东方国际科技大厦23层D室(200122)

电话: (86)21-68406123 传真: (86)21-68406266

苏州办事处: 江苏省苏州市高新区滨河路1156号金狮大厦21B3(215011)

电话: (86)512-65579173 传真: (86)512-65579073

西安办事处: 西安市大庆路125号蔚蓝印象A座1单元703室(710082)

电话: (86)29-84589121 传真: (86)29-84589121

沈阳办事处: 沈阳市铁西区建设东路11-2号韵动领地1-13-5(110021)

电话: (86)24-23527120 传真: (86)24-23527320



本社:

株式会社FUKUDA

地址: 日本东京都练马区贯井3-16-5
Add.: 3-16-5, Nukui, Nerima-ku, Tokyo, Japan

电话: (81) 33577-1111

传真: (81) 33577-1002

代理商:

C-FB-000295C-X-01

Printed in China